

**Muntagnard AG**  
**Herr Dario Pirovino**  
**Denter Tumas 6a**  
**7013 Domat/Ems**



**Prüfbericht**                      **2020L36588**  
Berichtsdatum                      30. Oktober 2020 / 15:14  
Auftragstyp                          Allg. Untersuchungen  
Auftraggeber                        Muntagnard AG, Herr Dario Pirovino

Bericht	Prüfmuster	Kurzbeurteilung
<b>2020L36588 / 1</b>	<b>black Maske</b>	<b>Anforderung erfüllt</b>

**Bewertung**

Die Maske erfüllt die Vorgaben der Empfehlungen der Swiss National COVID-19 Science Task Force für Community Masks.

Partikelrückhaltevermögen und Atemwiderstand entsprechen den Vorgaben.  
Eine Widerstandsfähigkeit gegen Spritzwasser ist vorhanden.  
Das Aussehen nach dem Waschen ist sehr gut.  
Der Tragekomfort wird als gut bewertet.

**Kennzeichnung**

Für Community Masks liegt die Empfehlung vor, folgenden Warnhinweis sinngemäss aufzubringen:

**WICHTIGER HINWEIS!**

Es handelt sich weder um ein medizinisches Produkt noch um eine persönliche Schutzausrüstung. Die Masken sind nicht zertifiziert. Sie dienen lediglich als Alternative zu zertifizierten Masken und stellen somit keinen Eigenschutz sicher. Die Benutzung ist eigenverantwortlich und beabsichtigt eine minimierte Verbreitung von Tröpfchen.

**Beurteilungsgrundlage**

«Recommendations for minimal specifications for the community masks for Swiss manufacturers» der Swiss National COVID-19 Science Task Force (NCS-TF) vom 25.04.2020

Bericht freigegeben durch: Robert Sporer, Prüfleiter  
Dieser Bericht wurde elektronisch signiert und ist somit rechtsgültig.  
Für Rückfragen steht Ihnen gerne Ihr Kundenberater zur Verfügung:  
Frau Nathalie Moravetz Telefon direkt +41 58 577 10 20

**Teilbericht 2020L36588 / 1**


Bezeichnung black Maske  
Menge 10  
Eingangsdatum 16.10.2020



<b>Technologische Prüfungen</b>			
<b>Parameter</b> <i>Methode (Standort)</i>	<b>Resultat</b>	<b>Einheit</b>	<b>Limit / Anforderung</b>
<b>Partikelrückhaltevermögen</b> <i>NTXMET100 (na) (Dietikon)</i>	<b>&gt;95</b>	<b>%</b>	<b>≥70</b>
<b>Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeitsspritzer</b> <i>NTXMET100 (na) (Dietikon)</i>	<b>stark</b>		<b>stark</b>
<b>Atemwiderstand</b> <i>NTXMET100 (na) (Dietikon)</i>	<b>54.2</b>	<b>Pa/cm<sup>2</sup></b>	<b>&lt;60</b>
<b>Dimensionsstabilität nach 10x 60 °C</b> <i>- (na) (Dietikon)</i>	<b>0</b>	<b>%</b>	
<b>Aussehen</b> <i>- (na) (Dietikon)</i>	<b>ok</b>		



Sehr guter Widerstand gegen Spritzwasser

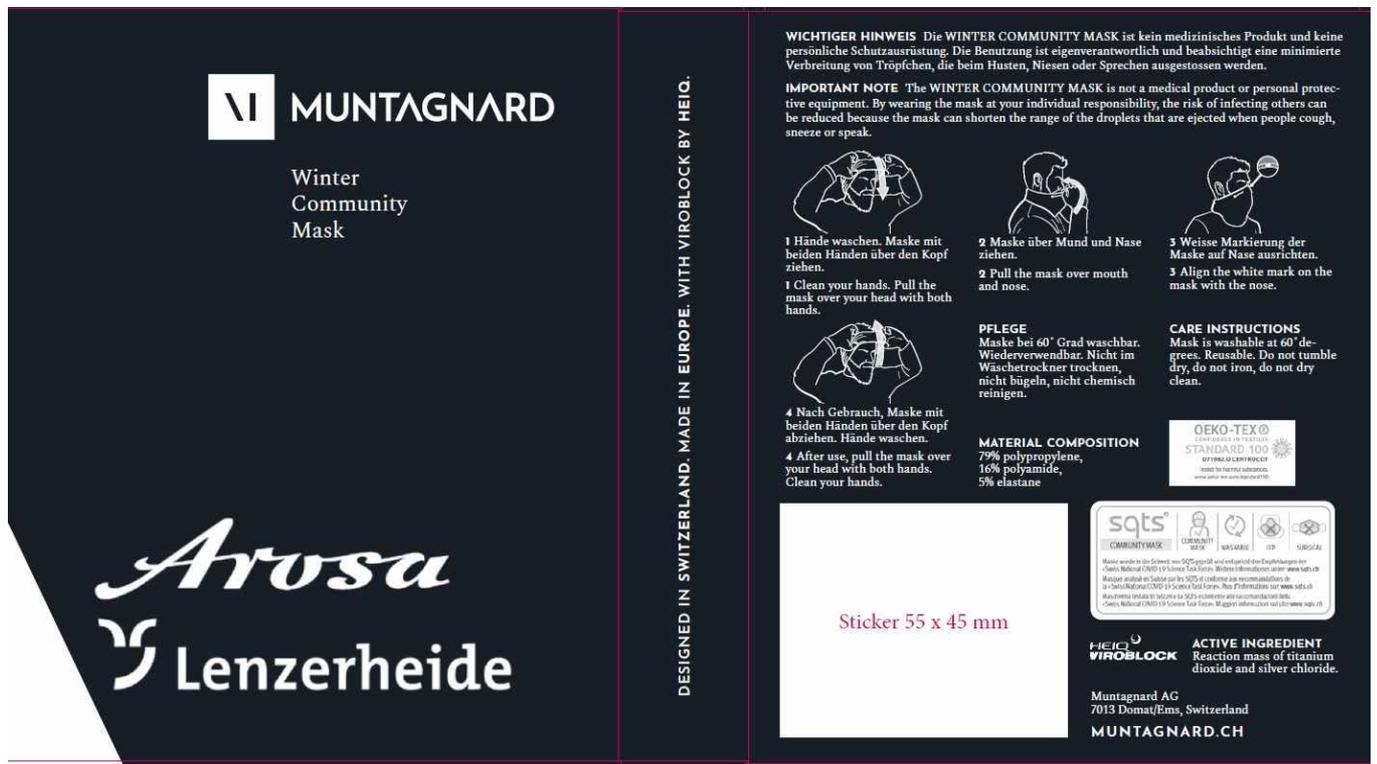

Kennzeichnung

NG: Nachweisgrenze  
BG: Bestimmungsgrenze

na: nicht im akkreditierten Bereich

nn: nicht nachweisbar

Die exakten Versuchsbedingungen und Details zu den Methoden geben wir Ihnen auf Anfrage gerne bekannt. Die Ergebnisse betreffen ausschliesslich die aufgeführten Proben wie erhalten. Es ist nicht erlaubt, diesen Bericht gekürzt oder Teile davon zu verwenden. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen ([www.sqts.ch](http://www.sqts.ch)).